

مقایسه میانگین بیلی روین سرمه اندازه گیری شده از طریق بیلی روینومتر با میانگین بیلی روین سرم در نوزادان زرد

دکتر مطهره گلستان^۱، دکتر عبدالحسین فاطمی^۲، دکتر امیربهرامی احمدی^۳

چکیده

مقدمه: هیپریلی روینمی یافته شایع و اکثراً خوش خیم نوزادان است ولی بیلی روین در غلظت‌های بالا و تحت شرایط خاص در شیرخوار نوروتوكسیک می‌باشد و ممکن است باعث کرن ایکتروس در نوزادان شود. روش استاندارد برای تعیین شدت زردی، اندازه گیری بیلی روین سرم می‌باشد که مستلزم نمونه گیری از ورید محیطی است که این کار باعث تحمیل استرس و درد به نوزاد و هم باعث صرف هزینه و وقت می‌گردد. اندازه گیری غیرتھاجمی غلظت بیلی روین از راه پوست، یک روش جایگزین برای تعیین میزان بیلی روین سرم می‌باشد. هدف از این مطالعه مقایسه بیلی روین اندازه گیری شده از طریق پوست به وسیله بیلی روینومتر JH20-1 با بیلی روین سرم بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مشاهده‌ای تحلیلی و به روش آینده‌نگر برروی ۱۰۰ نوزاد ترم از فروردین لغایت آبان ماه ۱۳۸۵ انجام شد. در ابتدا نوزادان توسط محقق معاینه و از نظر بالینی میزان بیلی روین تخمین زده می‌شد و سپس نمونه خون جهت اندازه گیری بیلی روین سرم ارسال شده و همزمان توسط بیلی روینومتر JH20-1 میزان بیلی روین در ۲ ناحیه پیشانی و استرنوم اندازه گیری می‌شد. در این مطالعه ضریب همبستگی بیلی روین بیلی روینومتر و بیلی روین از طریق بالینی با بیلی روین سرم اندازه گیری شده به وسیله آزمایشگاه مقایسه گردید.

نتایج: ۵۷ نوزاد پسر و ۴۳ دختر در این مطالعه بررسی شدند. میانگین بیلی روین آزمایشگاه ۱۳/۳۵ و میانگین بیلی روین بیلی روینومتر در ناحیه پیشانی ۱۲/۹۵ و در ناحیه استرنوم ۱۲/۴۹ بود که این سه مورد تفاوت چندانی با همدیگر نداشتند. ضریب هم بستگی بیلی روینومتر در ناحیه پیشانی با آزمایشگاه برابر ۰/۷۷۳ و بیلی روینومتر در ناحیه استرنوم با آزمایشگاه برابر ۰/۷۳۱ بود. در مقادیر بالاتر از ۱۲ میلی گرم در دسی لیتر (cut-off point) ویژگی افزایش و حساسیت کاهش و در مقادیر کمتر از ۱۲ حساسیت افزایش و ویژگی کاهش می‌یابد. و ضریب هم بستگی بیلی روین آزمایشگاه و مشاهده بالینی معادل ۰/۷۳۱ بود.

نتیجه گیری: استفاده از بیلی روینومتر JH20-1 در نوزادان ترم جهت اندازه گیری بیلی روین در مقایسه با بیلی روین سرم قابل قبول می‌باشد و بیلی روین اندازه گیری شده به وسیله بیلی روینومتر در ناحیه پیشانی به بیلی روین سرم نزدیک تر است. اما در بیلی روین بالاتر از ۱۲ حساسیت کاهش می‌یابد و قابل اعتماد نیست.

واژه‌های کلیدی: هیپریلی روینمی، بیلی روینومتر، بیلی روین سرم، نوزاد

مقدمه

اگرچه اکثراً گذرا و خود محدود شونده است ولی در صورت شدید بودن و عدم درمان مناسب و به موقع، می‌تواند با آسیب به سیستم اعصاب مرکزی به مرگ نوزاد و یا ضایعات عصبی پایدار (کرنيکتروس) منجر شود^(۱-۴).

زردی نشانه بالینی هیپریلی روینمی است. سالهاست که متخصصین به صورت بالینی، شدت زردی را ارزیابی کرده و از

هیپریلی روینمی یافته شایع و در بیشتر موارد خوش خیم است که در نوزادان بین روزهای ۷-۳ تولد مشاهده می‌شود^(۱)

*- نویسنده مسئول: استادیار گروه اطفال - تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۴۰۸۳؛ Email: golestan@ssu.ac.ir

-۲- دستیار گروه اطفال
-۳- پژوهش عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۲/۲۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۴/۲۰

از طریق خون گیری می تواند مشکل زا باشد^(۱۰-۱۲). اندازه گیری غیرتهاجمی بیلی روین از راه پوست یک روش جایگزین برای تعیین میزان بیلی روین می باشد^(۱۰) هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بیلیروین سرم از طریق آزمایشگاه با بیلی روینومتر JH20-1 و میزان بیلیروین از طریق مشاهده بالینی بوده است

روش بررسی

این مطالعه از نوع مشاهده ای تحلیلی است که به روش مقطعي، بر روی ۱۰۰ نوزاد که جهت اندازه گیری بیلیروین از فروردین لغایت آبان ۸۵ به بیمارستان مادر شهر یزد مراجعه کرده بودند انجام شد. انتخاب نمونه به روش آسان و ملاک انتخاب نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵٪ و توان آزمون ۸۰٪ با توجه به مطالعات مشابه قبلی و فرمول زیر بود.

$$N = [Z1-\alpha/2+Z1-\beta]/C]^2$$

$$C = 0.5 \times \ln[(1+\gamma)/(1-\gamma)]$$

معیارهای ورود به مطالعه نوزادان زرد فول ترم، وزن ۲۵۰۰ گرم یا بیشتر که قبلاً فوتورابی نشده باشند و معیارهای خروج از مطالعه شامل نوزاد نارس، وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، نوزاد مشکوک به سپتی سمی، منژیت و کلستاز و نوزادی که قبلاً فوتورابی شده باشد.

به منظور مقایسه کارآيی بیلی روینومتر JH20-1 با بیلی روین سرم از طریق آزمایشگاه و مشاهده بالینی زردی، در ابتدا نوزادان توسط محقق معاینه شده و مقدار بیلی روین از طریق کلینیکی تخمین زده شد. متعاقباً تست های آزمایشگاهی از نظر بیلی روین سرم ارسال و همزمان بیلی روین نوزاد از طریق بیلی روینومتر اندازه گیری گردید. در این تحقیق بیلی روینومتر JH20-1 از Ningbo David Medical Device CO-LTD شرکت سازنده استفاده قرار گرفت و آزمایش خون نیز توسط دستگاه اتو آنالیز و به روش RA-1000 صورت گرفت. اندازه گیری بیلی روین توسط بیلی روینومتر از طریق قرار دادن دکتور در ناحیه پیشانی و استرنوم صورت گرفت و نتیجه آن با تست های آزمایشگاهی و قضاویت بالینی مقایسه و ضریب همبستگی بین آنها محاسبه گردید. سنجش بالینی مقدار زردی بدین صورت بود که وجود زردی در ناحیه صورت تا گردن معادل ۵، ناحیه قفسه صدری و سینه معادل ۱۰، ناحیه شکم ۱۵ و کف پا معادل

آن برای تصمیم گیری در مورد اندازه گیری بیلی روین استفاده می کنند. انجمن کودکان آمریکا در الگوریتم برخورد با نوزاد زرد، اندازه گیری بیلی روین خون را منوط به زردی قابل توجه براساس قضاؤت بالینی می داند^(۱۵).

اشکال این پیشنهاد این است که توانایی برای تشخیص بالینی زردی قابل توجه متغیر و متفاوت بوده و در بعضی موارد ممکن است اشتباه باشد^(۱۶-۷). به علاوه افزایش بیلی روین قابل توجه از نظر بالینی به سطح سرمی واقعی و سن نوزاد برحسب ساعت بستگی دارد^(۱۴).

هیپریلی روبینی شدید اغلب در شیرخوارانی که در چند روز اول زندگی زرد هستند دیده می شود، بادرنظر داشتن این نکته لازم است همه نوزادان بدون توجه به عوامل خطره هیپریلی روبینی در طی ۹۶ ساعت بعد از تولد مجددًا معاینه شوند و نوزادانی که زردی قابل توجهی دارند مشخص و پیگیری و مداخله لازم صورت گیرد^(۵). اینگونه پیگیری همیشه محدود نیست و بسیاری از شیرخواران کمتر از ۴۸ ساعت مرخص شده و ممکن است ۱-۲ هفته بعد از ترخیص هم ویزیت نشوند^(۵).

آکادمی اطفال آمریکا (AAP) پیگیری سریع شیرخوارانی را که زودتر از ۴۸ ساعت از بیمارستان مرخص می شوند پیشنهاد نموده و متذکر می شود که بهتر است هر شیرخواری که قبل از ۷۲ ساعت از بیمارستان مرخص می شود در طی ۲-۱ روز بعد مجددًا ویزیت شود^(۸).

در صورت عدم توجه به این موضوع با افزایش زردی، بیلی روین آزاد در سرم افزایش یافته و به خارج از عروق منتشر شده و در بافت های مختلف از جمله سیستم اعصاب تجمع می باید و باعث ایجاد کرن ایکتروس در نوزاد می شود^(۹).

روش استاندارد برای تعیین شدت زردی اندازه گیری بیلی روین سرم می باشد که مستلزم نمونه گیری از ورید محیطی است که این کار باعث تحمیل استرس و درد به نوزاد و صرف هزینه و وقت برای والدین می گردد. همچنین در طی فوتورابی مجبور به نمونه گیری سریال از ورید محیطی برای تعیین بیلی روین سرم می باشیم که این امر باعث کم خونی در نوزادان می شود^(۱۰).

شیوع زیاد زردی از یک سو و تهاجمی بودن تعیین سطح بیلیروین

ضریب همبستگی بین بیلی رویین آزمایشگاه و بیلی رویین از طریق بیلی رویینومتر در ناحیه پیشانی معادل $r = 0.778$ و بین آزمایشگاه و بیلی رویینومتر در ناحیه استرنوم معادل $r = 0.773$ و بین آزمایشگاه و مشاهده بالینی معادل $r = 0.731$ بود ($P = 0.001$). با توجه به میانگین‌های بیلی رویین تخمین بالینی و بیلی رویین از طریق بیلی رویینومتر در ناحیه پیشانی و استرنوم و بیلی رویین سرم اختلاف معنی داری بین پسaran و دختران وجود نداشت.

با توجه به محاسبات آماری و منحنی ROC برای بیلی رویین $12/70$ میلی گرم در دسی لیتر (نقطه Optimum) حساسیت و ویژگی دستگاه حداقل است (شکل ۱). در این مطالعه حساسیت و ویژگی دستگاه cut-off را نسبت به نقطه بیلی رویین (12) (میانگین بیلی رویین) (point) سنجیدیم بررسی نشان داد که در مقادیر بیلی رویین بالاتر از 12 میلی گرم در دسی لیتر ویژگی دستگاه و در نتیجه موارد منفی کاذب افزایش یافته و حساسیت کاهش می یابد . و با مقادیر بیلی رویین پایین تر از 12 حساسیت دستگاه و موارد مثبت کاذب افزایش و ویژگی آن کاهش می یابد .

۲۰ میلی گرم در دسی لیتر در نظر گرفته شد . سپس توسط بیلی رویینومتر سه دفعه متوالی بیلی رویین اندازه گیری شده و معدل این 3 عدد حساب شده و در عدد 0.8 که انحراف دستگاه می باشد ضرب شد . دستورالعمل طبق نظر شرکت ارائه دهنده و بر طبق محاسبات ریاضی به دست آمده است . اطلاعات و داده های به دست آمده بعد از ثبت در پرسشنامه با استفاده از برنامه آماری SPSS 13 و همچنین رسم نمودار ROC در کامپیوتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

ضریب همبستگی : در صورتی که ضریب همبستگی بین دو معیار اندازه گیری شده بیش از 0.7 باشد از نظر آماری قابل اهمیت است ..

نتایج

در این مطالعه 57 پسر و 43 دختر بررسی شدند ، سن نوزادان $22 - 1$ روز (میانگین سنی $135/87 + 99/1$ ساعت) بود . نتایج اندازه گیری بیلی رویین به سه طریق (بیلی رویین اندازه گیری شده از طریق پوست به وسیله بیلی رویینومتر ، بیلی رویین سرم و میزان بیلی رویین تخمین بالینی) و میانگین آنها در جدول (۱) آورده شده است .

ROC Curve


Case Processing Summary

| billirut | Valid N (listwise) |
|-----------|--------------------|
| Positive* | 2 |
| Negative | 98 |

Larger values of the test result variable(s) indicate stronger evidence for a positive actual state.

a. The positive actual state is 12.00.

ROC Curve

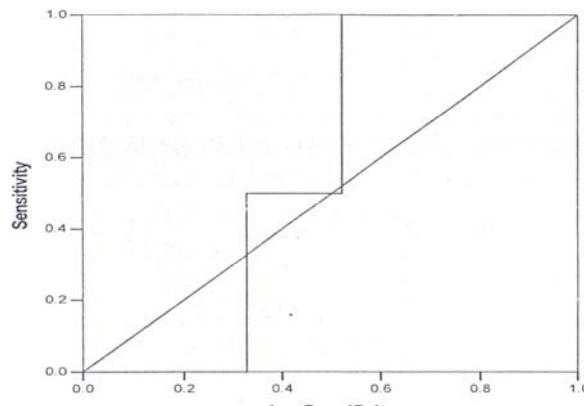

Area Under the Curve

Test Result Variable(s): billfm

| Area |
|------|
| .577 |

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار بیلی روین براساس کلینیک و بیلی روینومتر و تست‌های آزمایشگاهی در جامعه مورد بررسی

| بیلی روین | روین | بیلی روین | حداکثر بیلی | میانگین | انحراف | تعداد |
|-----------|-------|-----------|-------------|---------|---|-------|
| معیار | | | بیلی روین | روین | | |
| ۳/۰۴ | ۱۲/۱۱ | ۲۰ | ۶/۰۰ | ۱۰۰ | | |
| ۲/۴۲ | ۱۲/۹۵ | ۲۲ | ۷/۵۰ | ۱۰۰ | | |
| ۲/۷۰ | ۱۲/۴۹ | ۲۱ | ۶/۴۰ | ۱۰۰ | | |
| ۳/۴۳ | ۱۲/۳۵ | ۲۱/۱ | ۵/۸۰ | ۱۰۰ | | |
| | | | | | بیلی روین براساس کلینیک | |
| | | | | | بیلی روین بوسیله بیلی روینومتر در ناحیه پیشانی | |
| | | | | | بیلی روین بوسیله بیلی روینومتر در ناحیه استرنوم | |
| | | | | | بیلی روین آزمایشگاه | |

بحث

محاسبه گردید که ضریب همبستگی بیلی روینومتر I با آزمایشگاه $r=0.75$ و بیلی روینومتر II برابر $r=0.76$ بود. $(P<0.001)$ و در مطالعه Mahajan و همکاران که بیلی روین نوزادان ترم توسط بیلی روینومتر JM-102 اندازه گیری شده و ضریب همبستگی آن با آزمایشگاه محاسبه شده بود در ناحیه پیشانی معادل $r=0.878$ و در ناحیه استرنوم برابر $r=0.859$ بود.^(۱۶)

مطالعه ما که بر روی ۱۰۰ نوزاد ترم و با وزن بالاتر از ۲۵۰۰ گرم صورت گرفت، با توجه به ضریب همبستگی بین بیلی روین محاسبه شده از طریق بیلی روینومتر JH20-1 در ناحیه پیشانی با نتیجه آزمایشگاه $r=0.778$ و در ناحیه استرنوم برابر $r=0.773$ بوده و رابطه نزدیک نتایج بیلی روینومتر با آزمایشگاه ثابت گردید. نتیجه‌ای که در مطالعه به دست آمد کاملاً مشابه با نتایج کشور چین می‌باشد. علت اختلاف با سایر مطالعات احتمالاً به علت متفاوت بودن نوع دستگاه می‌باشد. در مطالعه ما ضریب همبستگی بیلی روینومتر با آزمایشگاه در ناحیه پیشانی بیشتر از استرنوم بود که مشابه با بررسی Mahajan Ebbesen^(۱۶) و Ochoa^(۱۸) در اسپانیا می‌باشد که ضریب همبستگی بیلیروبین آزمایشگاه با بیلیروبین استرنوم بیش از ناحیه پیشانی به وسیله بیلی روینومتر بوده است.

در مطالعه Carbonell در اسپانیا مقایسه‌ای بین بیلی روینومتر JM-102 و آزمایشگاه انجام شده و ضریب هم بستگی بین این دو $r=0.92$ با $P<0.001$ بود. در این تحقیق در بیلی روین 9 و 13 میلی گرم در دسی لیتر حساسیت دستگاه در ترتیب 100% و 94% بود. و ویژگی به ترتیب 47% و 51% بوده است، در این مطالعه برای سطح بیلی روین 13 میلی گرم در

اگرچه ممکن است نوزادان تازه متولد شده به هنگام ترخیص از بیمارستان فاقد زردی باشند لیکن ممکن است در روزهای بعد در خطر عوارض نورولوژیک ناشی از افزایش بیلی روین باشند.^(۵) بنابراین کنترل دقیق بیلی روین از طریق تست‌های آزمایشگاهی منطقی است، لذا این موضوع باعث ویزیت‌های مکرر و بررسی آزمایشگاهی بیلیروبین سرم و صرف وقت و هزینه برای والدین و تحمیل درد برای نوزاد می‌شود. یک روش غیرتهراجمی، تعیین بیلی روین از طریق پوست توسط بیلی روینومتر است که می‌تواند از تست‌های آزمایشگاهی مکرر و صرف هزینه برای والدین و تحمیل درد برای نوزاد جلوگیری و به عمل آورد.^(۵,۱۰) در مطالعه Tankl و همکاران در کشور چین با دستگاه بیلی روینومتر مشابه مطالعه ما (JH20-1) بروی ۲۵۳ نوزاد ترم، بیلی روین را در دو ناحیه پیشانی و استرنوم اندازه گیری و ضریب همبستگی آنها را با بیلی روین آزمایشگاه محاسبه نموده اند که در ناحیه پیشانی $r=0.78$ و در ناحیه استرنوم معادل $r=0.73$ بود. در این مطالعه بیلی روین 12 میلی گرم در دسی لیتر به عنوان cut-off point درنظر گرفته شده بود و نتیجه اینکه در مقادیر بالاتر حساسیت دستگاه کاهش و در مقادیر پایین تر از 12 حساسیت دستگاه نشان داد.^(۱۳)

در مطالعه Moscicka بیلی روین 100 نوزاد ترم با دستگاه Minolta-Airshield-101 بیلی روین تعیین شده توسط آزمایشگاه مقایسه و ضریب هم بستگی این دو معادل $r=0.56$ بود.^(۱۴) در مطالعه Brown در فیلadelفیا که بروی 30 نوزاد ترم انجام شد از طریق دو نوع بیلی روینومتر، بیلی روین آنها در ناحیه پیشانی اندازه گیری شده و ضریب همبستگی با آزمایشگاه

آزمایشگاه بود که نتیجه شیوه به مطالعه تایلند است. مطالعه دیگری در کشور چین^(۲۰) مقدار بیلی‌روبینومتر JM-102 با تست‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید که ضریب همبستگی آن دو در ناحیه پیشانی $r=0.80$ و در ناحیه استرنوم $r=0.75$ بود. $P=0.001$) که نتایج مطالعه ما با آن مشابه می‌باشد. طبق هر دو مطالعه ضریب همبستگی هردو بیلی‌روبینومتر با آزمایشگاه در ناحیه پیشانی از استرنوم بیشتر است. مطالعه‌ای که در سوئیس انجام گرفته ضریب همبستگی تخمین کلینیکی با آزمایشگاه $r=0.74$ بوده است که نتایج حاصله از تحقیق ما با آن مشابه است. مطالعه‌ای که توسط Fimino بروی نوزادان با سن حاملگی ۳۰ هفته به بالا انجام داد نتیجه گرفت عواملی مانند جنس نوزاد و سن حاملگی اثری بروی اندازه گیری بیلی‌روبین توسط بیلی‌روبینومتر ندارد^(۲۱). در مطالعه ما نیز جنس نوزادان در میزان بیلی‌روبین توسط بیلی‌روبینومتر تأثیری نداشت.

نتیجه گیری

استفاده از بیلی‌روبینومتر JH20-1 در نوزادان ترم جهت اندازه گیری بیلی‌روبین در مقایسه با بیلی‌روبین سرم از طریق آزمایشگاه قابل قبول است و بهتر این است که بیلی‌روبینومتر در ناحیه پیشانی به کار برده شود. بیلی‌روبینومتر JH20-1 در مقادیر بیلی‌روبین حدود ۱۲ می‌تواند جایگزین تست‌های آزمایشگاهی شود ولی در مقادیر بالاتر حساسیت دستگاه پایین بوده و قابل اعتماد نمی‌باشد.

سپاسگزاری

بدینوسیله از پرستل بخش نوزادان بیمارستان مادر که در انجام این تحقیق ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی می‌شود.

References

- 1- M.Jeffery Maisels, Nenatal Hyperbilirubinemia , Klaus. MA. Avory A, Fanarff , *Care of the High risk Neonate* , Philadelphia W.B .Saunders 2001 5th ed : 324- 357.
- 2- Barbara J. Stoll and Robert M. Kliegman , Digestive System Disorder , *Jaundice and Hyperbilirubinemia In the Newborn* Behrman RE,

دسی‌لیتر حساسیت دستگاه 50% و ویژگی برابر 52% بود و برای سطح بیلی‌روبین ۹ میلی‌گرم در دسی‌لیتر حساسیت دستگاه 100% و ویژگی 82% بود ، در مطالعه ما با افزایش مقادیر بیلی‌روبین حساسیت دستگاه کاهش و ویژگی آن افزایش می‌یابد و با کاهش مقادیر بیلی‌روبین حساسیت دستگاه افزایش و ویژگی آن کاهش می‌یابد ، که نتیجه مشابه مطالعه اسپانیا می‌باشد^(۵).

در مطالعه دیگری که در کشور تایلند بروی ۱۳۴ نوزاد ترم توسط ۲ بیلی‌روبینومتر 103 JM و Bilicheck میزان را انجام شد. نتایج با تست‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید. ضریب همبستگی بیلی‌روبینومتر 103 JM با آزمایشگاه $r=0.82$ بود. بیلی‌روبینومتر JM میزان بیلی‌روبین را 0.7 میلی‌گرم در دسی‌لیتر کمتر از مقادیر آزمایشگاه نشان داد و بر عکس بیلی‌روبینومتر Bilicheck بیلی‌روبین را 0.6 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بیشتر از مقادیر آزمایشگاه نشان می‌داد. همچنین بیلی‌روبینومتر JM در 4% موارد اختلاف به میزان $2-2/9$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در 2% موارد اختلاف به میزان $3-3/9$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر با آزمایشگاه نشان داد^(۱۹). در مطالعه ما بیلی‌روبینومتر 1- JH20 در ۹۸ مورد بیلی‌روبین را کمتر از مقادیر آزمایشگاه نشان داد و فقط در ۲ مورد این میزان بیشتر از آزمایشگاه بود و میزان اختلاف بیلی‌روبین آزمایشگاه و بیلی‌روبینومتر 1- JH20 در ناحیه پیشانی در ۸۷ نوزاد کمتر از ۱ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و در ۷ مورد بین $1-1/99$ میلی‌گرم و در ۴ مورد بین $2-2/99$ میلی‌گرم و در ۲ نوزاد بین $3-3/99$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود.

میانگین بیلی‌روبین حاصل از بیلی‌روبینومتر مطالعه ما در ناحیه پیشانی 0.40 و در ناحیه استرنوم 0.86 کمتر از میانگین بیلی‌روبین

Kliegman RM, Jenson MB. Nelson Textbook of pediatrics W.B.Saunders Philadephia 17th ed 2004: 592-598

3- Ronald j. wong, Glenn H. Desandre, Eric sibley, and David k. Stevenson, *Neonatal Jaundice and Liver disease*, Richard J. Martin, Avroy A. Fanaroff, Michele C. Walson, in-Neonatal

- Perinatal Medicine, Philadelphia, Mosby 2006, 8th ed: 419-426.
- 4-** M. Jeffreyn Maisels, jaundice. Mhairi G, Macdonald, Martha D. Mullent Mary M.K. seshia, Avery, Neonatalatology, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkin 2006 6th ed: 769-774.
- 5-** Carbonell Estrany X. Botet Mussons F. Figueras Aloy J, Riu Godo A : *Hyperbilirubinemia in full-term newborns – predictive factors*. 10 an Esp pedaitr. 1999. 50(4) : 389-92.
- 6-** Moyer VA, Ahn C, Sneed S. *Accuracy of clinical judgment in neonatal jaundice*. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000; 154:391-394.
- 7-** Tayaba R, Gribetz D, Gribetz I, Holzman IR. *Noninvasive estimation of serum bilirubin*. Pediatrics 1998; 102(3). Available at: pediatrics. Org/cgi/ content/ full/102/3/e28 .
- 8-** Sanpavat S. Nuchprayoon 1, Smathakanee C, Hansuebsai R *Nomogram for prediction of the risk of neonated hyperbilirubinemia, using transcutaneous bilirubin*. J Med Assoc thai 2005 88(9): 1187-93
- 9-** Ahlfors CE: *Unbound bilirubin associated with kernicterus: a historical approach*. J pediatr. 2000; 137(4): 540-4.
- 10-** Janjindamai W, Tansantiwong T. *Accuracy of transcutaneous bilirubinometer estimates using Bili check in thai neonates*. J Med Assoc thai 2005 88(2): 187-90.
- 11-** Stevenson DK, Vreman HJ. *Carbon monoxide and bilirubin production in neonates*. Pediatric 1997; 100-252-254.
- 12-** Schumacher RE. *Noninvasive measurements of bilirubin in the new born*. Clin perinatal. 1990; 17:417-435.
- 13-** Tan KL, China Hp, Koh BC : *Transcutaneous bilirubinometry in Chinese, Malay and Indian infants*. Acta paediatr . 1996 ; 85(8) : 986-90.
- 14-** Mosicka A, Gadzinowski J, Mosicki A, Breborowicz GH, Opala T: *Usefulness of transcutaneous measurements of bilirubin in infants with jaundice*. Ginekol pol . 1994 ; 65(6) : 271-5.
- 15-** Brown LP , Amold L, Allison D, Jacobsen B, Klein ME, Charsha D: *Transcutaneous bilirubinometer reliability* J perinatol. 1990. 10(2): 167-9.
- 16-** Mahajan G, Kaushal RK, Sankhyan N , Sharma RL, Nakra M: *Transcutaneous bilirubinometer in assessment of neonatal jaundice in northern India*. Indian pediatr. 2005; 42(1): 41-5.
- 17-** Ebbesen F, Rasmussen LM , Wimberley PD: *A new Transcutaneous bilirubinometer, Bilichek , used in the neonatal intensive care unit and the maternity ward*. Acta paediatr. 2002; 91(2) : 203-11.
- 18-** Ochoa sangrador C, Marugan Isabel VM, Tesoro Gonzalez R, Garcia Rivera MT, Hernandez calvo MT: *Evaluation of a Transcutaneous bilirubinometer*. 9: An Esp pediatr. 2000 ; 52 (6) : 561-8.
- 19-** Sanpavat S. Nuchprayoon I, *Comparison of two transcutaneous bilirubinometers Minolta. Airshields jaundice meter JM 103 and spectrx Bilicheck in thai neonates*. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005. Nov 36(6): 1533-7.
- 20-** Ey, Lee SY, Chow CB, Chung JW *Bilicheck transcutaneous bilirubinometer: a screening tool for neonatal jaundice in the Chinese population Ho*. Hong kong Med J 2006, 12(2): 99-102.
- 21-** Firmino F.Rubatelli, Gelnn R. Gourlly, Norbert loskamp, Neena Modi. *Transcutaneous Bilirubin Measurement: A Multicenter Evaluation of a new Device pediatr* 2001; 107(6) : 1264-1271.